

广州美姿生物科技有限公司

成品检验报告（面膜）

表格编号：QA-QR-06(A/0)

产品名称	川奈之汀 玻尿酸深层补水面膜	批号	BH23MD02	检验日期	2023.8.26	报告日期	2023.8.31	
规格	30ml	执行标准	QB/T2872-2017			样品数量	1片	
项目		企业、国家标准				结果	单项评价	仪器
感官指标	色泽	与样板一致				一致	√	目视
	香味	与样板一致				一致	√	嗅觉
	外观	与样板一致				一致	√	目视
理化指标	pH 值	4.0—8.5				5.98	√	pH计
	耐热	(40±1)℃保持24h, 恢复至室温后无分层现象				无异常	√	恒温培养箱
	耐寒	(-5±1)℃保持24h, 恢复至室温后无分层现象				无异常	√	低温试验箱
	粘度、粘度 (25℃) mpa's (转子数, 转速)	规定值				1176 2# 12r 48.5%	√	粘度计
卫生指标	细菌菌落总数	≤1000cfu/g				<10cfu/g	√	恒温培养箱
	霉菌和酵母菌菌落总数	≤100cfu/g				<10cfu/g	√	生化培养箱
容量要求		符合规定				符合	√	电子称
包装要求		符合规定				符合	√	目视
标示		符合规定				符合	√	目视
总评								
备注：打“-”表示该项免检。打“√”表示该项合格。								
检验人：方玉芬				审核人：姚建华				




广州美姿生物科技有限公司

成品检验报告 (面膜)

表格编号: QA-QR-06(A/0)

产品名称	川奈之汀 玻尿酸深层补水面膜	批号	BH23MD01	检验日期	2023.8.25	报告日期	2023.8.30
规格	30ml	执行标准	QB/T2872-2017		样品数量	1片	
项目		企业、国家标准			结果	单项评价	仪器
感官指标	色泽	与样板一致			一致	√	目视
	香味	与样板一致			一致	√	嗅觉
	外观	与样板一致			一致	√	目视
理化指标	pH 值	4.0-8.5			6.01	√	pH计
	耐热	(40±1) °C 保持24h, 恢复至室温后无分层现象			无异常	√	恒温培养箱
	耐寒	(-5±1) °C 保持24h, 恢复至室温后无分层现象			无异常	√	低温试验箱
	粘度、粘度 (25°C) mpa's (转子数, 转速)	规定值			1185 2# 12r 48.7%	√	粘度计
卫生指标	细菌菌落总数	≤1000cfu/g			<10cfu/g	√	恒温培养箱
	霉菌和酵母菌菌落总数	≤100cfu/g			<10cfu/g	√	生化培养箱
容量要求		符合规定			符合	√	电子称
包装要求		符合规定			符合	√	目视
标示		符合规定			符合	√	目视
总评	合格						
备注: 打“-”表示该项免检。打“√”表示该项合格。							
检验人: 方玉芬				审核人: 姚建华			

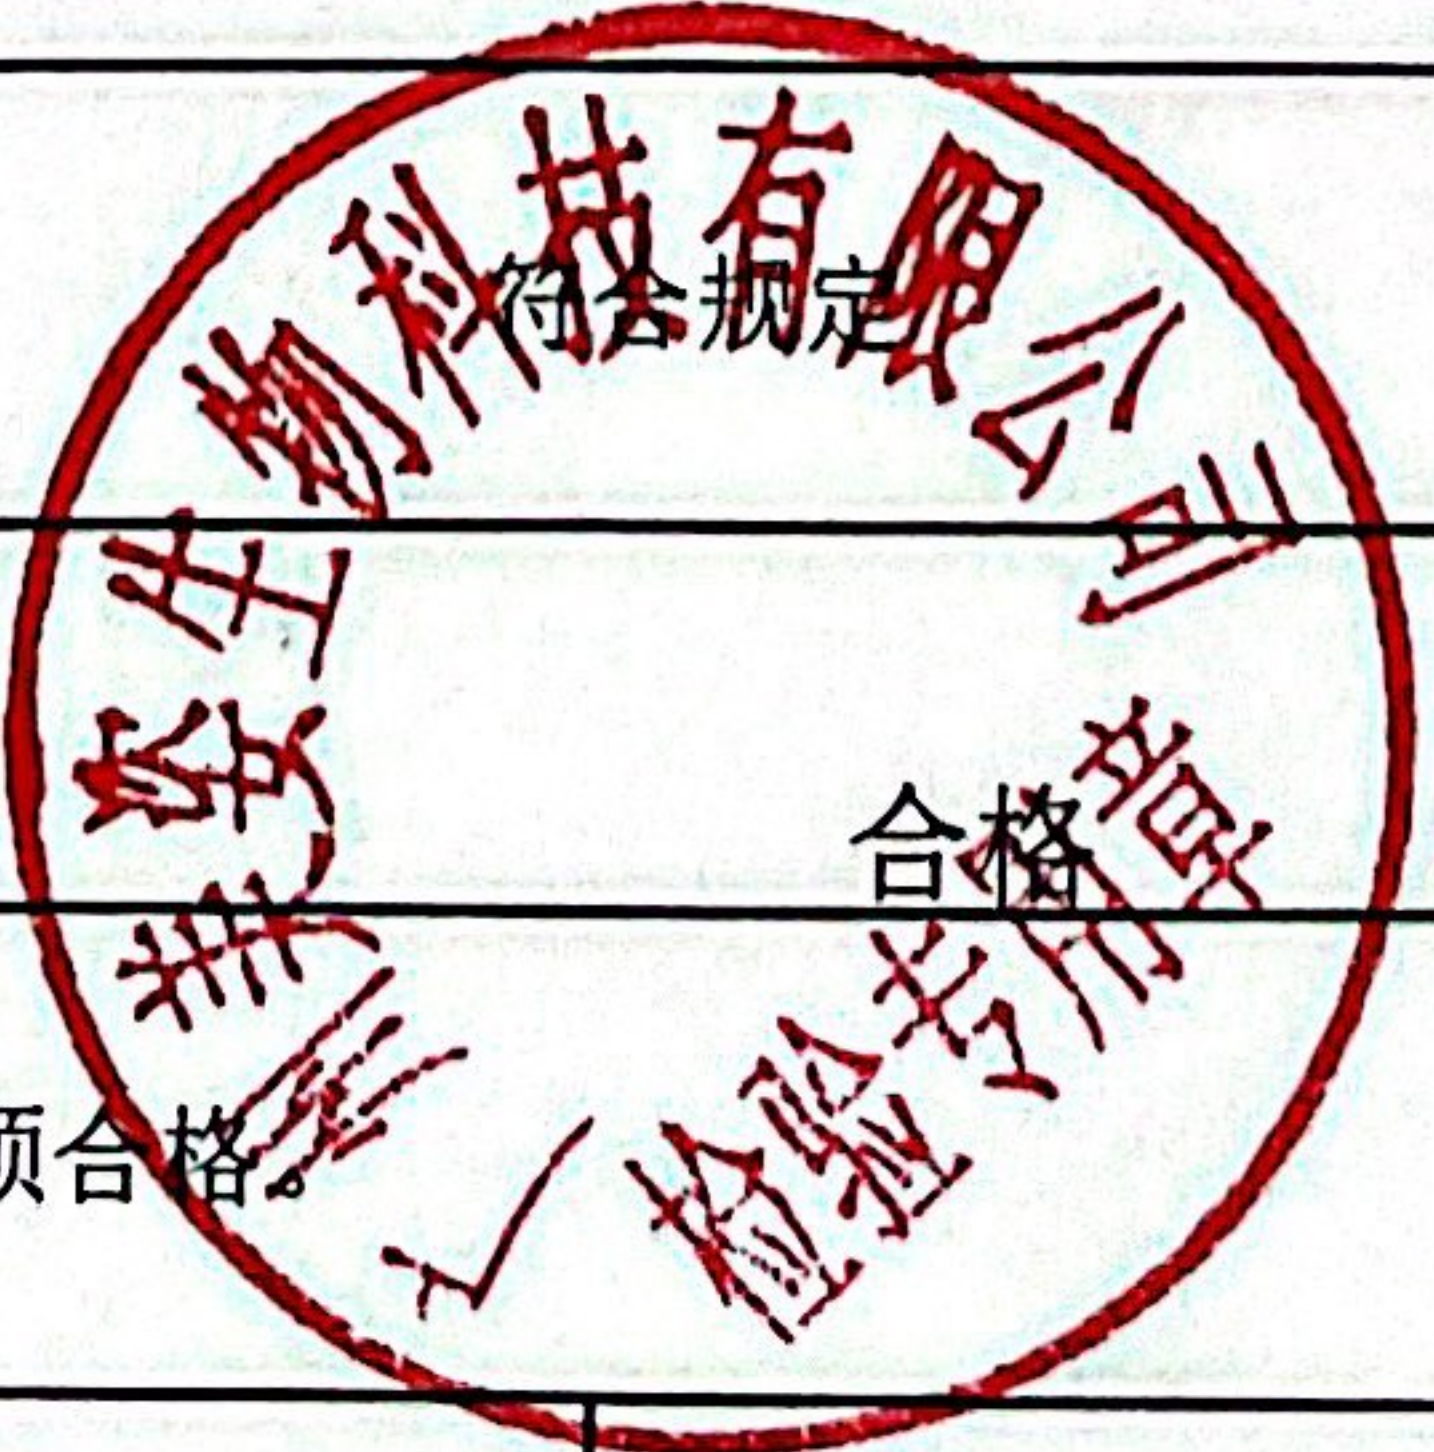

广州美姿生物科技有限公司

成品检验报告（面膜）

表格编号：QA-QR-06(A/O)

产品名称	川奈之汀 玻尿酸深层补水面膜	批号	BH22MD02	检验日期	2023. 8. 26	报告日期	2023. 8. 31	
规格	30ml	执行标准		QB/T2872-2017		样品数量	1片	
项目		企业、国家标准				结果	单项评价	仪器
感观指标	色泽	与样板一致				一致	√	目视
	香味	与样板一致				一致	√	嗅觉
	外观	与样板一致				一致	√	目视
理化指标	pH 值	4.0-8.5				6.00	√	pH计
	耐热	(40±1) °C保持24h, 恢复至室温后无分层现象				无异常	√	恒温培养箱
	耐寒	(-5±1) °C保持24h, 恢复至室温后无分层现象				无异常	√	低温试验箱
	粘度、粘度 (25°C) mpa's (转子数, 转速)	规定值				1199 2# 12r 49.4%	√	粘度计
卫生指标	细菌菌落总数	≤1000cfu/g				<10cfu/g	√	恒温培养箱
	霉菌和酵母菌菌落总数	≤100cfu/g				<10cfu/g	√	生化培养箱
容量要求		符合规定				符合	√	电子称
包装要求		符合规定				符合	√	目视
标示		符合规定				符合	√	目视
总评								
备注：打“-”表示该项免检。打“√”表示该项合格。								
检验人：方玉芬				审核人：姚建华				



广州美姿生物科技有限公司

成品检验报告 (面膜)

表格编号: QA-QR-06(A/0)

产品名称	川奈之汀 玻尿酸深层补水面膜	批号	BH22MD01	检验日期	2023.8.25	报告日期	2023.8.30
规格	30ml	执行标准	QB/T2872-2017		样品数量	1片	
项目		企业、国家标准			结果	单项评价	仪器
感观指标	色泽	与样板一致			一致	√	目视
	香味	与样板一致			一致	√	嗅觉
	外观	与样板一致			一致	√	目视
理化指标	pH 值	4.0-8.5			5.98	√	pH计
	耐热	(40±1) °C 保持24h, 恢复至室温后无分层现象			无异常	√	恒温培养箱
	耐寒	(-5±1) °C 保持24h, 恢复至室温后无分层现象			无异常	√	低温试验箱
	粘度、粘度 (25°C) mpa's (转子数, 转速)	规定值			1159 2# 12r 47.6%	√	粘度计
卫生指标	细菌菌落总数	≤1000cfu/g			<10cfu/g	√	恒温培养箱
	霉菌和酵母菌菌落总数	≤100cfu/g			<10cfu/g	√	生化培养箱
容量要求		符合规定			符合	√	电子称
包装要求		符合规定			符合	√	目视
标示		符合规定			符合	√	目视
总评	合格						
备注: 打“-”表示该项免检。打“√”表示该项合格。							
检验人: 方玉芬				审核人: 姚建华			

