



231710110192

检验检测报告

No: XNZJ/JYBG-2025-0019

样品名称: 湿巾 (心相印牌湿巾)

委托单位: 孝感市孝南区市场监督管理局

生产单位: 恒安 (孝感) 医疗器械科技有限公司

检验检测类别: 区级监督抽查

孝感市孝南区产品质量监督检验所



扫描全能王 创建

孝感市孝南区产品质量监督检验所

检验检测报告

No: XNZJ/JYBG-2025-0019

第 1 页 共 3 页

样品名称	湿巾 (心相印牌湿巾)	检验检测类别	区级监督抽查	
规格型号	200mm×160mm	样品数量	12 包	
生产日期/批号	限用日期: 20270108	质量等级	合格品	
生产单位	恒安 (孝感) 医疗器械科技有限公司	商标	心相印牌	
生产单位地址	湖北省孝感市孝南经济开发区 316 国道复线恒安 (孝感) 医疗器械科技有限公司 B4 栋一楼生产车间			
备注: 以上样品信息由委托单位提供, 本机构不对样品的真实性负责				
样品状态描述	包装完好			
收样日期	2025 年 01 月 09 日	检测日期	起	2025 年 01 月 15 日
			止	2025 年 01 月 27 日
检验项目	1. 偏差; 2. 含液量; 3. 包装密封性能; 4. pH; 5. 可迁移性荧光增白剂; 6. 细菌菌落总数; 7. 大肠菌群; 8. 致病性化脓菌; 9. 真菌菌落总数。			
检验依据	GB/T 27728-2011《湿巾》及相关测试方法标准 (详见数据页)、《2024 年孝南区生活用纸及纸制品产品质量监督抽查实施细则》			
判定依据	GB/T 27728-2011《湿巾》、《2024 年孝南区生活用纸及纸制品产品质量监督抽查实施细则》			
主要仪器设备	1. 真空密封性能测试仪; 2. 酸度计; 3. 暗箱式三用紫外分析仪; 4. 生化培养箱; 5. 霉菌培养箱。			
试验环境	物理性能检验: 温度 (23.0±1.0) °C 相对湿度 (50.0±2.0) %R.H.			
检验检测结论	经抽样检验, 所检项目符合 GB/T 27728-2011《湿巾》标准要求, 依据《2024 年孝南区生活用纸及纸制品产品质量监督抽查实施细则》, 判定为合格。 (加盖检验检测专用章) 签发日期: 2025 年 01 月 27 日			
备注	依据 GB/T 27728-2011《湿巾》人体用湿巾判定。			

批准:

徐明刚

审核:

张明刚

编制:

杨



扫描全能王 创建



检验检测结果

No: XNZJ/JYBG-2025-0019


第 2 页 共 3 页

序号	检验检测项目/参数	单位	标准规定限值	检验检测结果	单项判定	依据检验检测标准	
1	偏差	长度	%	≥-10	+4	合格	GB/T 27728-2011 第 6.2.1 章
		宽度		≥-10	0	合格	GB/T 27728-2011 第 6.2.2 章
2	含液量	倍	≥1.7	2.4	合格	GB/T 27728-2011 第 6.3 章	
3	包装密封性能	-	合格	合格	合格	GB/T 27728-2011 附录 A	
4	pH	-	3.5~8.5	6.1	合格	GB/T 1545-2008	
5	可迁移性 荧光增白剂	-	无	无	合格	GB/T 27728-2011 附录 D	
6	细菌菌落总数	cfu/g	≤200	<20	合格	GB 15979-2002 附录 B	
7	大肠菌群	-	不得检出	未检出	合格	GB 15979-2002 附录 B	
8	致病性化脓菌	金黄色葡萄球菌	-	不得检出	未检出	合格	GB 15979-2002 附录 B
		绿脓杆菌	-	不得检出	未检出	合格	GB 15979-2002 附录 B
		溶血性链球菌	-	不得检出	未检出	合格	GB 15979-2002 附录 B
9	真菌菌落总数	cfu/g	≤100	<20	合格	GB 15979-2002 附录 B	
			(以下空白)				



检验检测结果

来样照片:

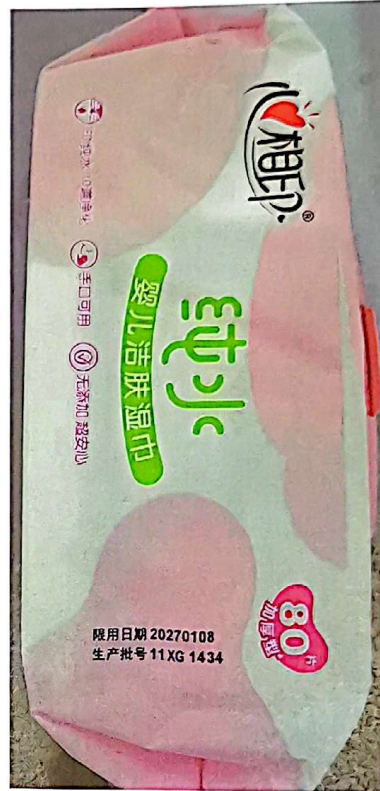

样品名称: 湿巾 (心相印牌湿巾) 样品编号: XNZJ/WT-2025-0019-01

