

仅供贵州每物商贸有限公司备案使用



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0518

# 检 验 报 告

检验编号：WR-2025-116

仅供贵州每物商贸有限公司备案使用

样品名称：天然胶乳橡胶避孕套

委托单位：利洁时（中国）投资有限公司

检验类别：委托检验

中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司

（国家乳胶制品质量检验检测中心）

仅供贵州每物商贸有限公司备案使用



# 仅供贵州每物商贸有限公司备案使用

## 注 意 事 项

- 1、检验报告无检验检测专用章或检验机构公章无效。
- 2、检验报告复印件未重新加盖检验检测专用章或检验机构公章无效。
- 3、检验报告无检验、审核和批准人的签字无效。
- 4、检验报告涂改无效，检验报告不完整无效。
- 5、对检验报告若有异议，为了您的利益，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

6、检验报告仅适用于所检样品，不得以其作为产品推销的依据。

7、报告中带“\*”处由委托单位提供，检验机构对委托方提供信息的真实性不承担法律责任，当委托方提供的信息影响检测结果的有效性时，检验机构不承担法律责任。

地 址：湖南省株洲市荷塘区新华东路 818 号

邮政编码：412003

电 话：0731-22495120

传 真：0731-22495101

网 址：<http://www.latextest.com>

邮 箱：Latex101@sina.com

仅供贵州每物商贸有限公司备案使用

# 仅供贵州每物商贸有限公司备案使用

## 中国化工株洲橡胶研究院有限公司

(国家乳胶制品质量检验检测中心)

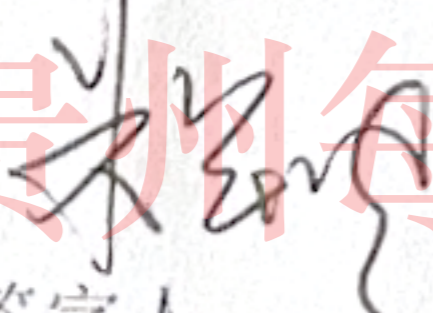

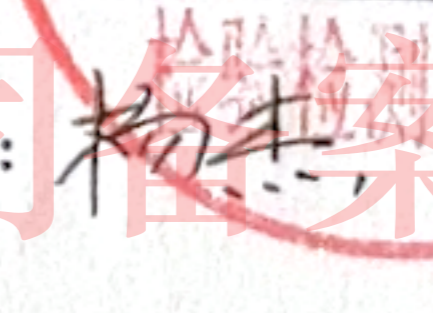
### 检 验 报 告

检验编号: WR-2025-116

共 3 页第 1 页

样品名称*	天然胶乳橡胶避孕套	规格型号*	52 mm, 直壁平面结构
商标*	杜蕾斯	来样方式	客户邮寄
委托单位名称及地址*	利洁时(中国)投资有限公司 北京市朝阳区东大桥路9号楼2单元401室内B01单元		
样品来源信息*	青岛伦敦杜蕾斯有限公司		
送(抽)样者*	赵磊	送(抽)样日期*	2025.5.23
样品状态	样品完好	样品批号*	1002877011
批量(抽样基数)*	176400 只	来样数量	1400 只
到样日期	2025.5.26	检验依据	GB/T 7544—2019
检验日期	2025.5.27-29	环境条件	(22-23) °C
检验类别	委托检验	报告编写者	黄超
检验结论: 经检验, 样品所检项目性能符合 GB/T 7544—2019 标准的要求。			
签发日期: 2025年5月30日			
备注: /			

橡胶研究  
检测专用

批准:  审核:  主检:  仅供贵州每物商贸有限公司备案使用

授权签字人



仅供贵州每物商贸有限公司备案使用  
中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司

(国家乳胶制品质量检验检测中心)

检 验 报 告

检验编号: WR-2025-116

共 3 页第 2 页

检验项目	指标	检验结果			结论	
		AQL	Ac/n	物理性能 不合格数 AQL		
爆破体积和压力	$\geq 18.0 \text{ dm}^3$	1.5	10/315	12.0-36.5 2	2 <1.5	合格
	$\geq 1.0 \text{ kPa}$			0.70-1.65 2		
尺寸	长度 $\geq 160 \text{ mm}$	13 只样品 均需满足	0	185-190 0	0 N/A	合格
	宽度 $52 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$			52.5-53.0 0		
针孔	无可见和不可见针孔以及撕裂	0.25	2/315	符合要求 0	<0.25	合格
可见缺陷	无破损、缺失或严重变形的卷边, 以及胶膜粘合而形成的永久皱折	0.4	3/315	符合要求 0	<0.4	合格
包装完整性	不出现连续气泡, 包装内没有可见试验液体	2.5	2/32	符合要求 0	<2.5	合格

备注:

- 1) 避孕套中部宽度为 52.5 mm, 爆破体积应不小于 18.0 dm<sup>3</sup>;
- 2) 针孔试验采用漏水试验法。

复核: 李超

检验: 杨杰

仅供贵州每物商贸有限公司备案使用

仅供贵州每物商贸有限公司备案使用

中国化工株洲橡胶研究院有限公司

(国家乳胶制品质量检验检测中心)

# 检 验 报 告

检验编号: WR-2025-116

共 3 页第 3 页

样品照片:



仅供贵州每物商贸有限公司备案使用